

Service: Qualité des laboratoires

**MANUEL D'UTILISATION DU TOOLKIT :
EEQ SEROLOGIE INFECTIEUSE**
(Instructions pour les participants)

Date de mise à jour : 26/03/2019

Manuel d'utilisation du Toolkit : enquête serologie infectieuse

Se connecter d'abord au Toolkit: il y a deux manières pour ce faire:

- par le site web du service de Qualité des Laboratoires (https://www.wiv-isp.be/QML/index_fr.htm); ensuite sélectionner dans la colonne de gauche sous la rubrique « BIOLOGIE CLINIQUE » « TOOLKIT BIOLOGIE CLINIQUE »
- ou directement: <https://biocli.wiv-isp.be/toolkit/login/login.cfm>

Ensuite introduisez votre numéro de labo et votre mot de passe (Fig. 1). Vous pouvez retrouver votre numéro de labo sur toute correspondance personnalisée que nous vous envoyons; le mot de passe est le même que celui que vous utilisez dans les autres programmes EEQ. Si vous ne connaissez pas ce mot de passe, vous pouvez le demander soit à votre directeur de labo (qui a reçu il y a quelques années une lettre mentionnant ce mot de passe) soit à vos collègues d'autres programmes EEQ ou envoyer une demande par e-mail à EQAtoolkit@sciensano.be après quoi nous vous enverrons en retour un e-mail qui reprendra le mot de passe de votre laboratoire.

Ensuite vous cliquez sur la flèche  pour vous connecter (Fig. 1).



sciensano

EKE/EEQ Toolkit

Labonummer/Numéro labo

Wachtwoord/Mot de passe

→

Fig. 1

A la page suivante vous choisissez le domaine « SEROLOGIE INFECTIEUSE » dans la liste déroulante (Fig. 2).

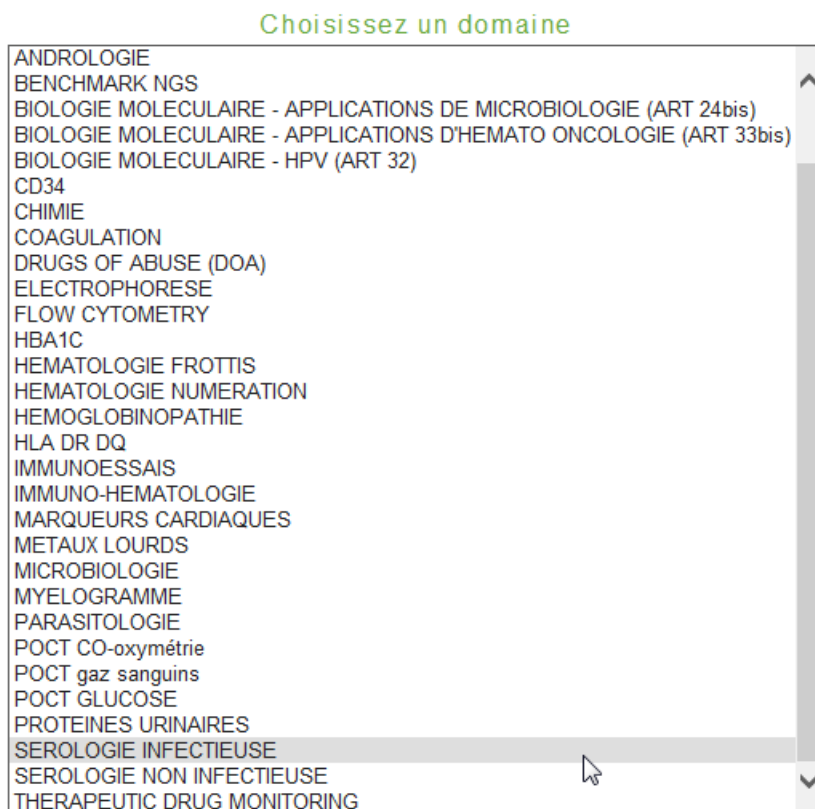


Fig. 2

Vous avez maintenant accès à la page d'accueil de sérologie infectieuse où vous choisissez « INTRODUCTION RESULTATS » (Fig. 3).



Fig. 3

A la page suivante (Fig. 4), vous pouvez choisir, à l'aide des listes déroulantes, l'enquête et l'échantillon. Le plus simple est de choisir « Tous les échantillons de cette enquête », mais vous pouvez choisir chaque échantillon séparément si vous le souhaitez. Après avoir fait votre choix, vous cliquez sur « SUBMIT » (Fig. 4).



Veillez sélectionner l'enquête et l'échantillon

Domaine SEROLOGIE INFECTIEUSE Enquête Echantillon

Fig. 4

Vous arrivez à la page où vous pouvez introduire vos résultats (Fig. 5). En haut de page : remplir la « Date de réception de l'échantillon » à l'aide d'une liste déroulante. S'il y a plusieurs échantillons par enquête, vous ne devez introduire ces données qu'une fois; le système les enregistre et les fait apparaître automatiquement pour l'(les) échantillon(s) suivant(s). Vous pouvez également prendre connaissance de la date de clôture de l'enquête.

 Kris.Vermelen@sciensano.be
Tél. : 02/6425529

test1 - (99999)

SEROLOGIE INFECTIEUSE

Date	Date de réception de l'échantillon	Closing date
08-01-2019 10:38	02/10/2018 <input type="text"/>	10-01-2019

Si vous répondez « other », veuillez reprendre le nom de la firme et de la trousse dans le texte libre

Rubella

Echantillon IS/12485

Échantillons IS/12485 et IS/13167 : reconstituez avec aq. dest. selon les indications sur le flacon.
Vous ne devez effectuer que les tests que vous effectuerez en routine sur le même type d'échantillon.

Informations cliniques :

Une jeune femme enceinte, qui réside dans une maison d'hébergement pour réfugiés, se présente chez le médecin avec un rash et de la fièvre. Les données concernant son statut de vaccination sont inconnues. Son fils de 2 ans aurait eu récemment la rubéole.

Fig. 5

Par paramètre vous devez ensuite remplir les résultats suivants:

- le réactif, où vous devez d'abord choisir la firme dans une liste déroulante (Fig. 6); après avoir choisi la firme, il vous est possible de choisir votre trousse (Fig. 7); si votre firme et/ou trousse ne se trouve(nt) pas dans la liste, vous pouvez choisir « OTHER » et remplir dans la case du texte libre en bas de page (Fig. 17) la firme et/ou trousse concernée.

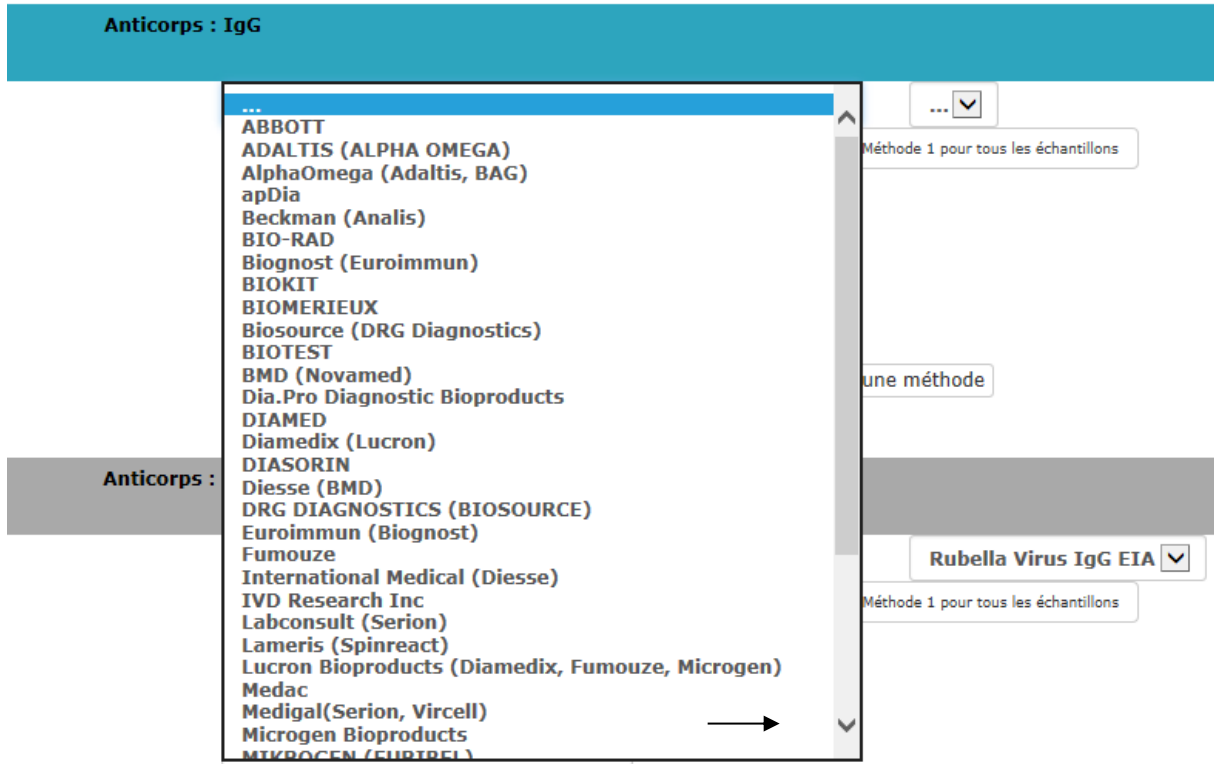


Fig. 6

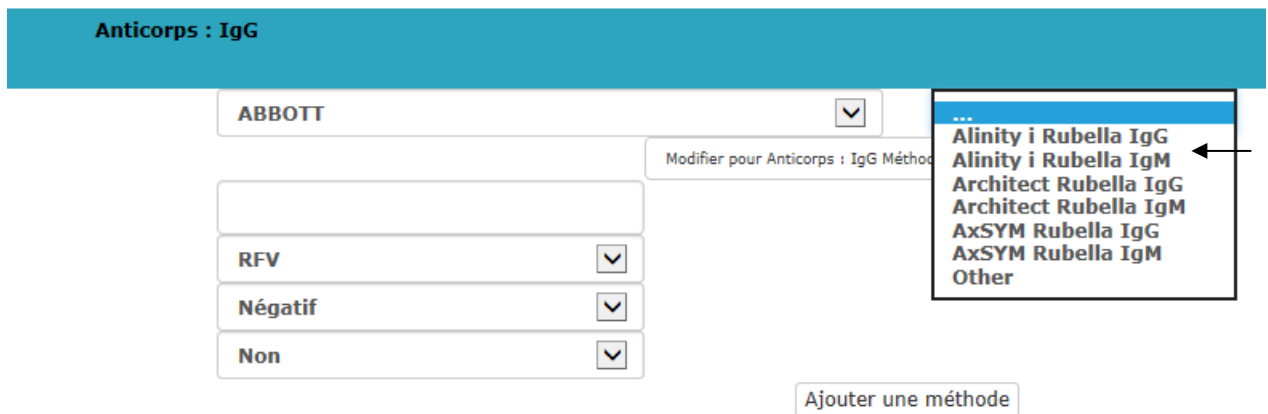


Fig. 7

- le résultat numérique, si d'application (vous pouvez remplir dans ce champs aussi bien des valeurs numériques que les signes « < » et « > ») (Fig. 8);




Fig. 8

si vous choisissez l'unité « titre » (Fig. 9), vous ne devez remplir que le dénominateur; le système complète automatiquement par « 1/... ».

Fig. 9

- l'unité utilisée pour votre technique (si d'application): de nouveau vous pouvez le choisir à partir d'une liste déroulante (Fig. 10)

Fig. 10

- l'« interprétation » (positif, négatif ou borderline) (Fig. 11)

Fig. 11

- la réponse à la question de savoir si vous effectuez ce test en routine sur l'échantillon concerné (Fig. 12).

Fig. 12

Si vous avez utilisé plus d'une méthode pour un paramètre, il suffit de cliquer sur « Ajouter une méthode » (Fig. 13).

Anticorps : IgG

ABBOTT [v] Architect Rubella IgG [v]

Modifier pour Anticorps : IgG Méthode 1 pour tous les échantillons

150

IU/L [v]

Positif [v]

Oui [v]

Ajouter une méthode

Fig. 13

Vous pouvez maintenant introduire les résultats de la 2^e méthode à la même manière de la 1^{er} méthode (Fig. 14). De cette manière vous pouvez introduire 3 méthodes différentes par paramètre (Fig. 14).

Anticorps : IgG

Méthode 1

Réactif utilisés

Résultat numérique

Unité utilisée

Interprétation

Effectuez-vous ce test en routine sur cet échantillon ?

ABBOTT [v] Architect Rubella IgG [v]

Modifier pour Anticorps : IgG Méthode 1 pour tous les échantillons

150

IU/L [v]

Positif [v]

Oui [v]

Ajouter une méthode

Anticorps : IgG

Méthode 2

Réactif utilisés

Résultat numérique

Unité utilisée

Interprétation

Effectuez-vous ce test en routine sur cet échantillon ?

... [v] ... [v]

Modifier pour Anticorps : IgG Méthode 2 pour tous les échantillons

...

... [v]

... [v]

... [v]

Ajouter une méthode | Supprimer la méthode

Fig. 14

Après avoir rempli les résultats de tous les paramètres que vous avez effectués, il faut ensuite répondre l'interprétation clinique sous « QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES » (Fig. 15).

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES

CODES INTERPRETATIONS (00490)

001	<input type="checkbox"/>	Pas d'immunité	(00495)
002	<input checked="" type="checkbox"/>	Immunité	(00500)
003	<input type="checkbox"/>	Possibilité d'une infection récente	(00505)
999	<input type="checkbox"/>	Autre :	(00510)

Fig. 15

De manière analogue, vous pouvez introduire les « Remarques », si d'application (Fig. 16).

CODES REMARQUES	
001	<input checked="" type="checkbox"/> Une confirmation n'est pas nécessaire
002	Une confirmation est nécessaire par : <input type="checkbox"/> a. Tests supplémentaires : <input type="checkbox"/> b. Un nouveau prélèvement <input type="checkbox"/> c. Envoi au laboratoire de référence
999	<input type="checkbox"/> Autre : <input type="text"/>

Fig. 16

Finalement, dans la case "Texte libre", il vous est possible d'introduire toute information que vous estimez utile (Fig. 17).

Texte libre

Fig. 17

Après que vous ayez introduit tous vos résultats, vous cliquez sur « SUBMIT » (Fig. 18).




Fig. 18

Vous accédez maintenant à une page, où vous pouvez contrôler tous les résultats que vous avez introduits (Fig. 19).



Evaluation Externe de la Qualité

[Print your results](#)

Merci, vos résultats ont été enregistrés

[Retour vers INTRODUCTION RESULTATS](#)

[Retour au menu](#)

test1 - (99999)

SEROLOGIE INFECTIEUSE

Date 08-01-2019 11:11	Date de réception de l'échantillon 02/10/2018
--------------------------	--

Rubella

Echantillon IS/12485

Échantillons IS/12485 et IS/13167 : reconstituez avec aq. dest. selon les indications sur le flacon.
Vous ne devez effectuer que les tests que vous effectueriez en routine sur le même type d'échantillon.

Fig. 19

Si vous cliquez au-dessus de la page sur le bouton « Print your results » (Fig. 19, Fig. 20),



Fig. 20

Vous obtiendrez une page, qu'il vous est possible de sauvegarder et/ou d'imprimer afin d'avoir une preuve écrite de votre réponse (Fig. 21).

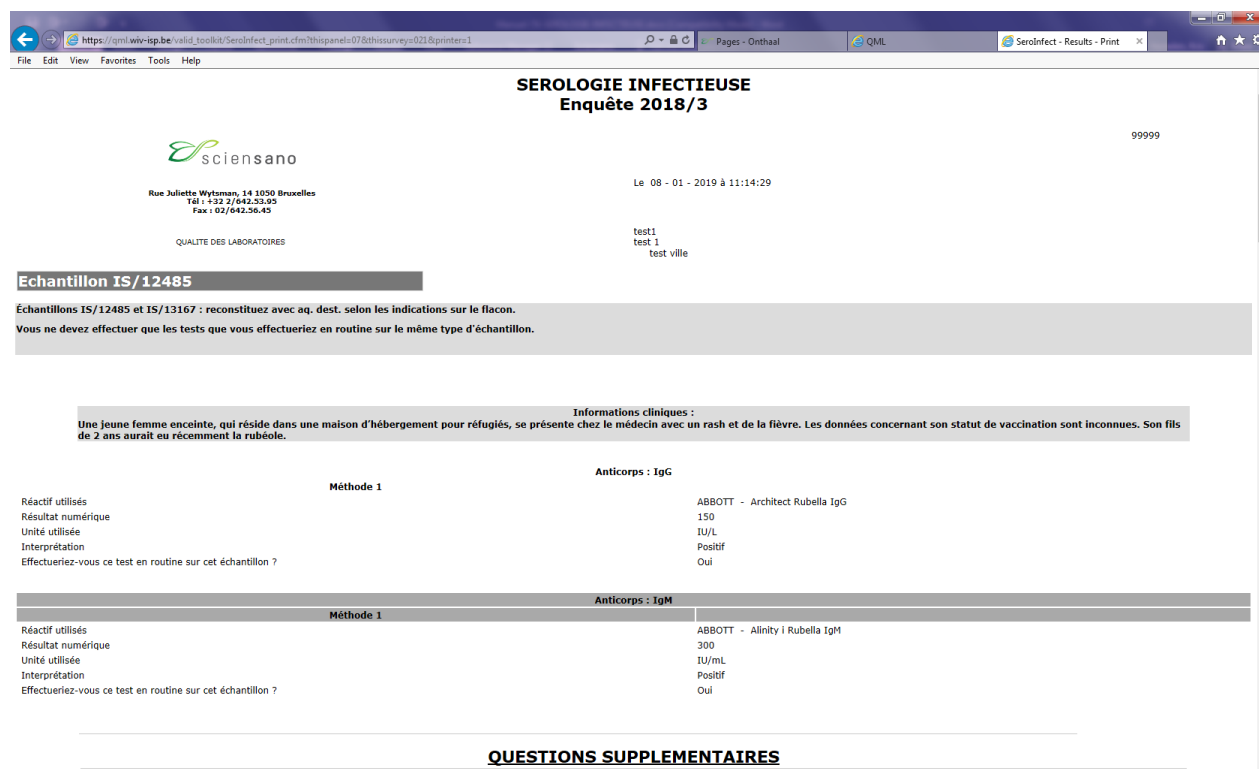


Fig. 21

Si quelque chose n'était pas clair ou en cas de difficulté, n'hésitez pas à nous contacter via EQAtoolkit@sciensano.be.

Kris Vernelen
Coordinateur EEQ MSP
Qualité des Laboratoires
Sciensano